



Comprovació de l'estat de calibració del AFM





Especimen de calibració 1

Període: $0.66 \mu\text{m}$


Alçada del graó: $0.05 \mu\text{m}$

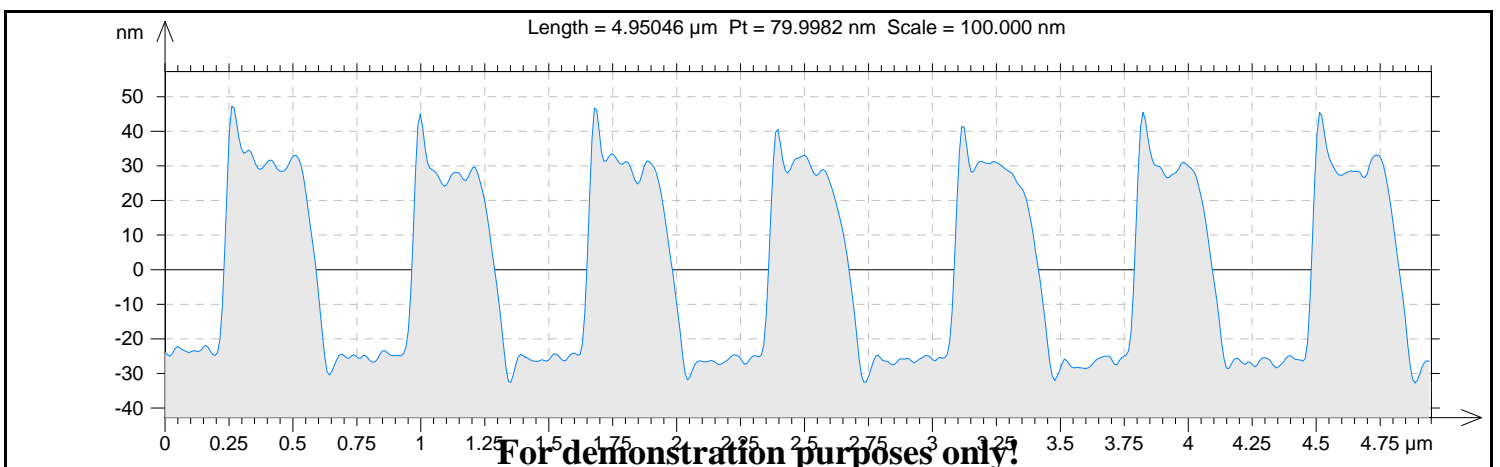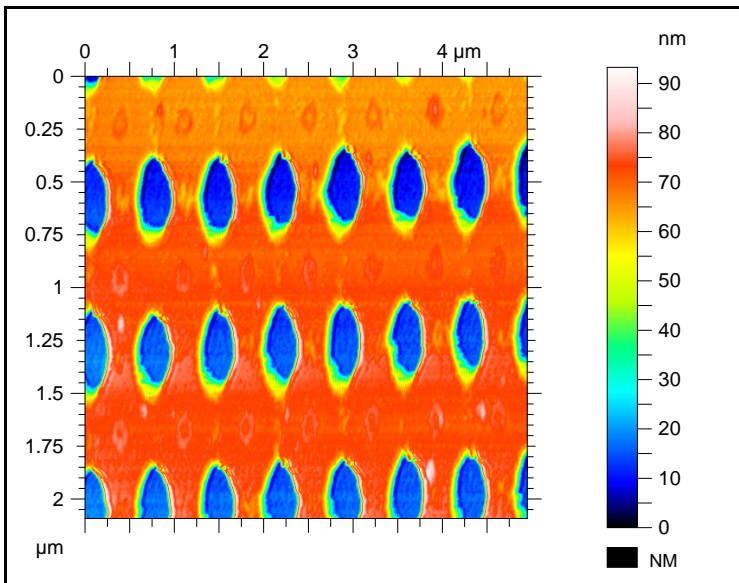

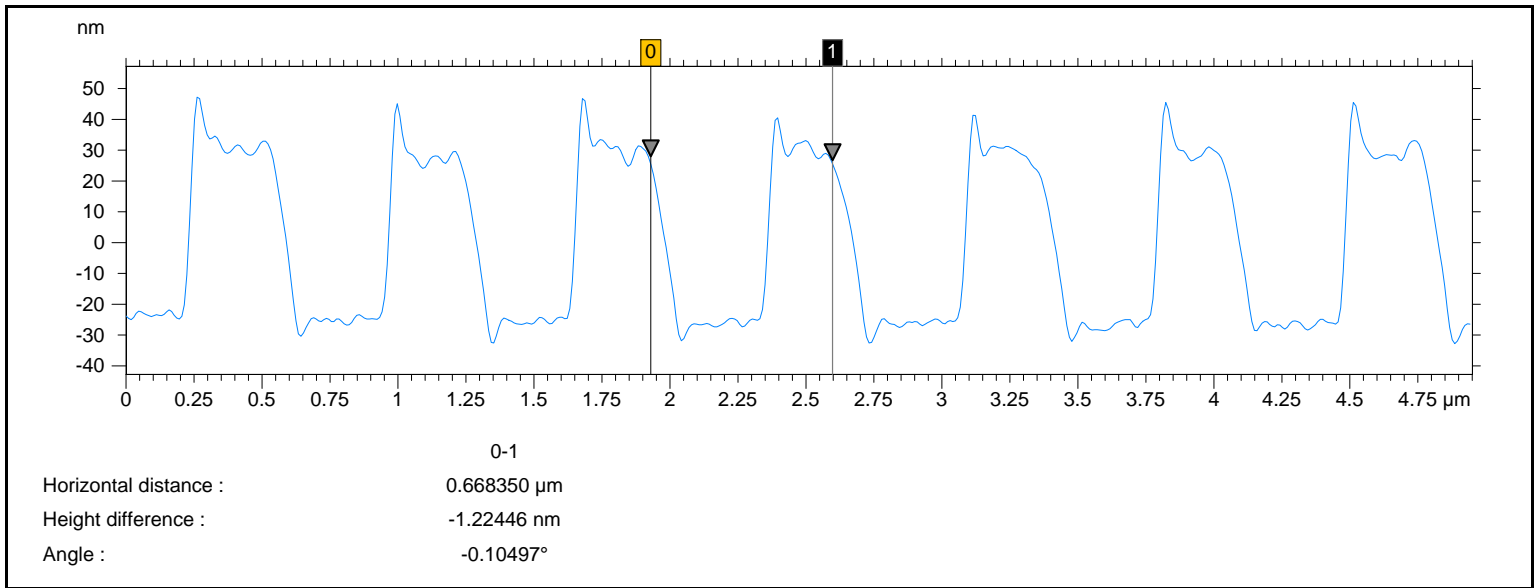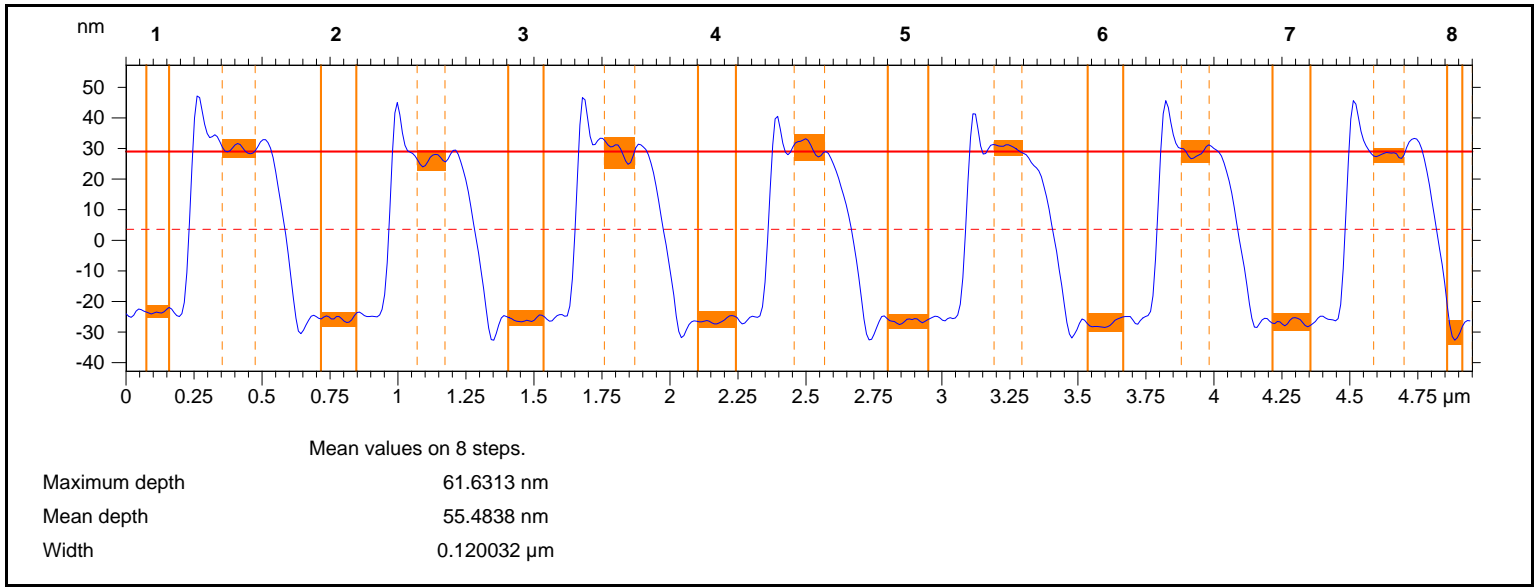

Mean depth = 55.4838 nm
Correcte
 Value: 50.0000 nm
 Tolerance 5.50000 nm

Horizontal distance (0-1) = 0.668350 μm
Correcte
 Value: 0.660000 μm
 Tolerance 0.050000 μm



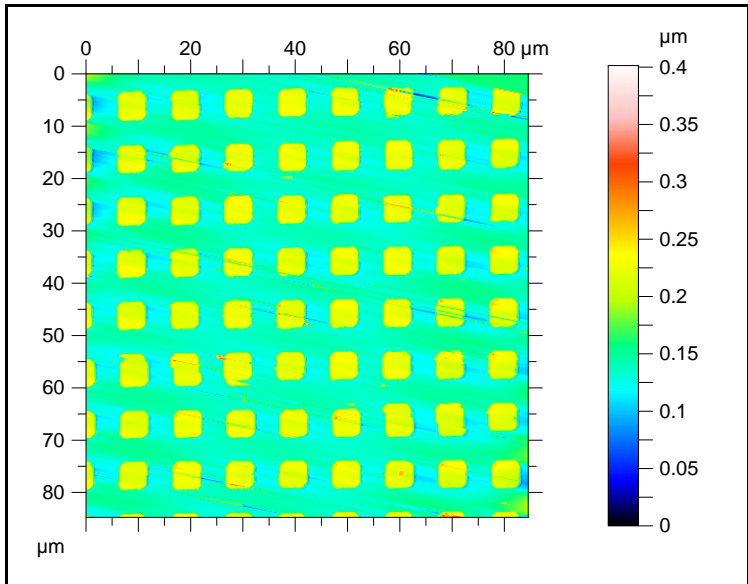


For demonstration purposes only!


Especimen de calibració 2

Periode: 10.0 μm

Alçada del graó: 0.10 μm

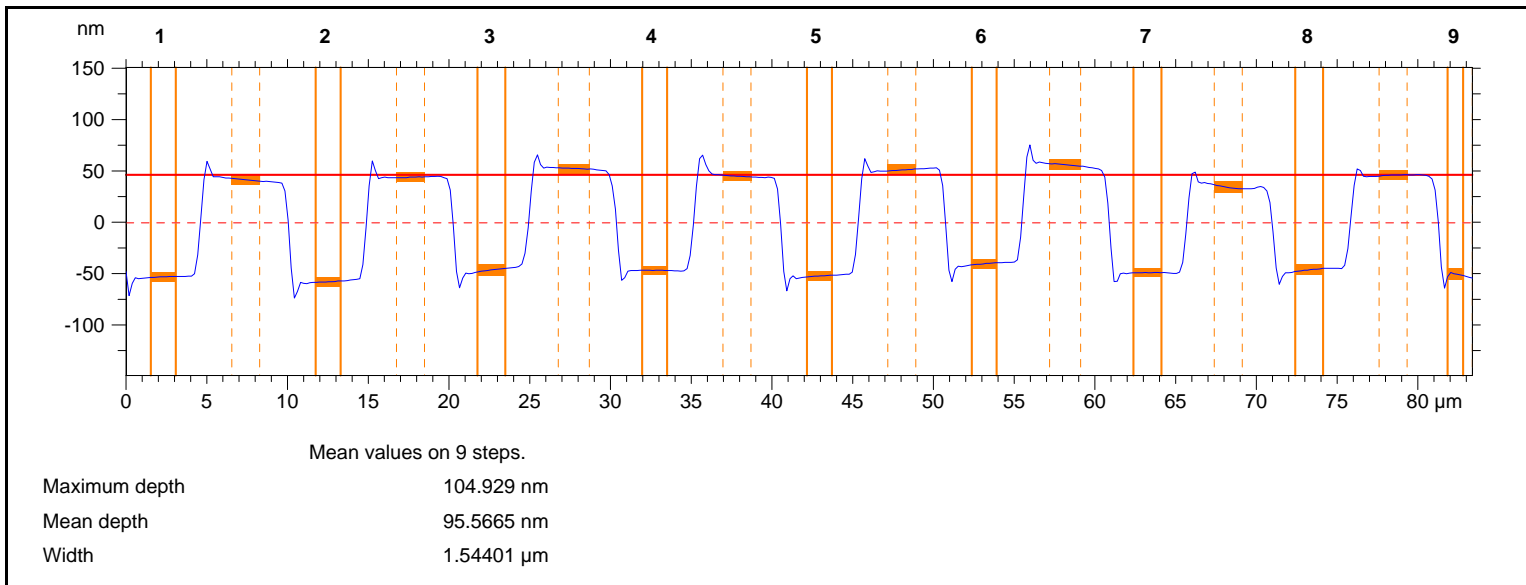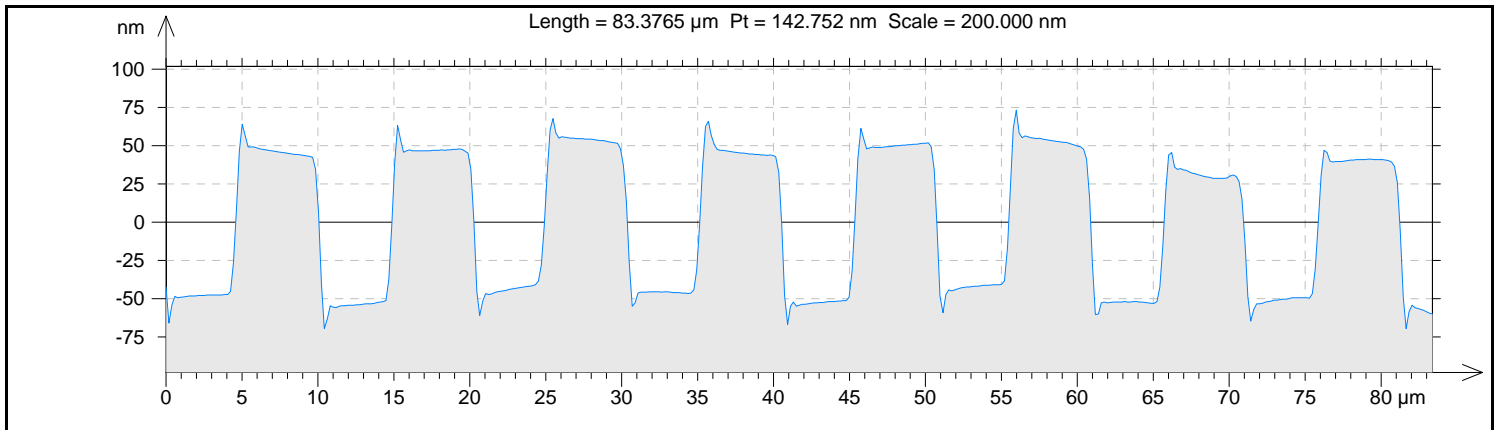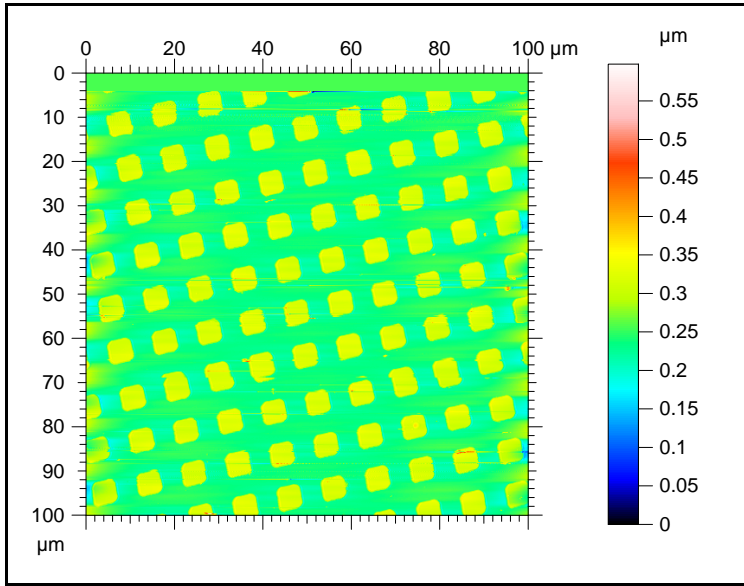

For demonstration purposes only!

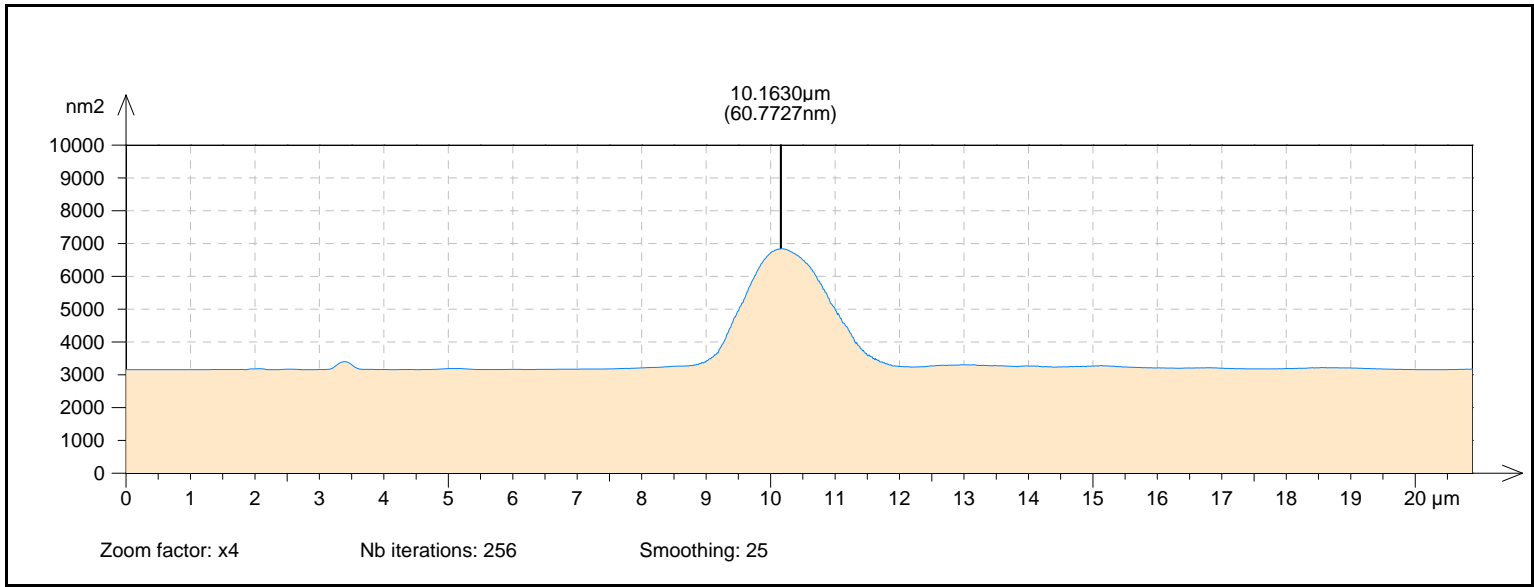

Mean depth = 95.5665 nm
Correcte
 Value: 100.000 nm
 Tolerance 5.50000 nm

Horizontal distance = 10.1630
Correcte
 Value: 10.0 μm
 Tolerance: 0.20 μm

For demonstration purposes only!