

Comprovació de l'estat de calibració del AFM






Data: 11 gener 2012




For demonstration purposes only!

Especimen de calibració 1

Periode: 0.66 μm
 Alçada del graó: 0.05 μm

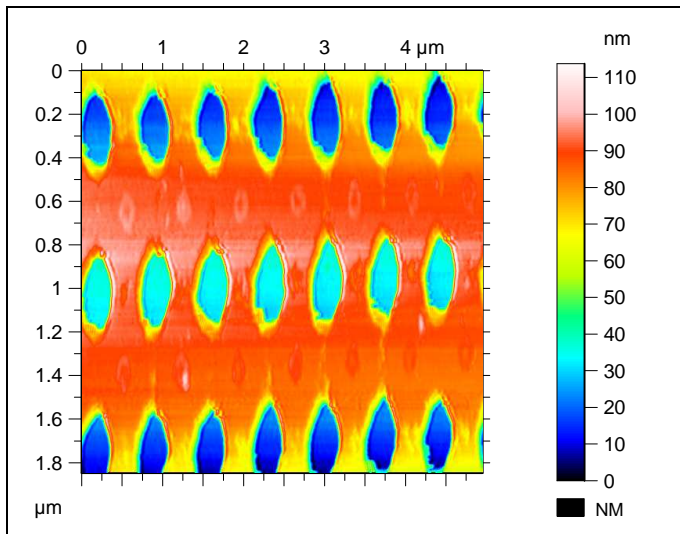




For demonstration purposes only!




For demonstration purposes only!

Especimen de calibració 2

Periode: 10.0 μm
 Alçada del graó: 0.10 μm

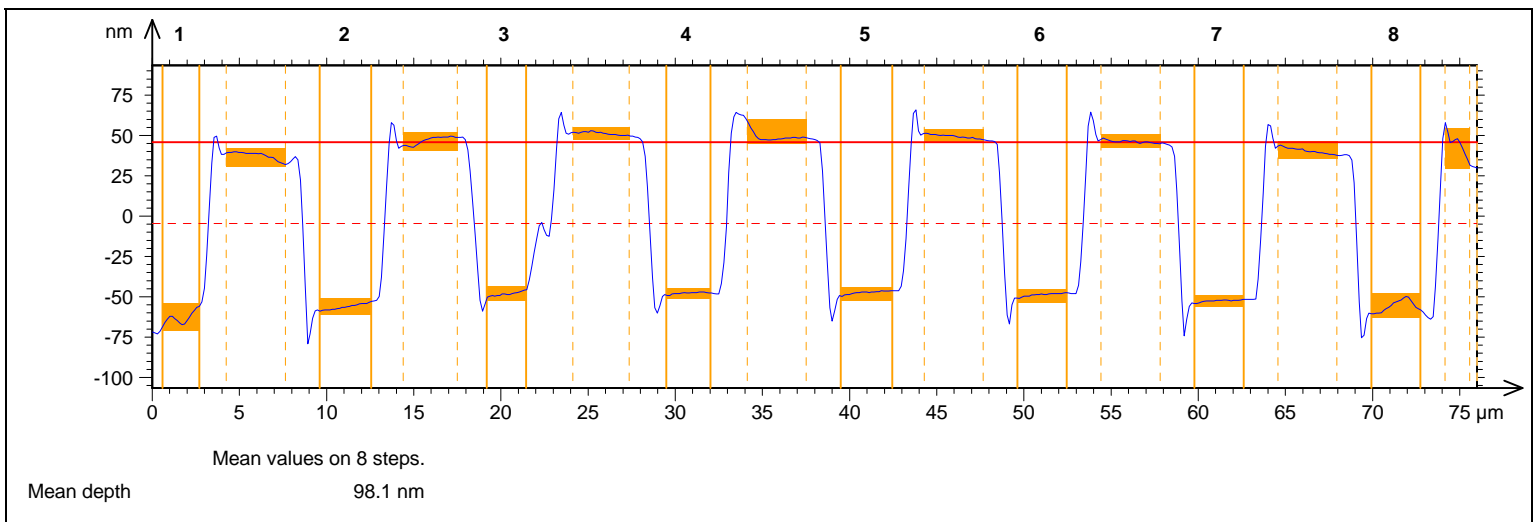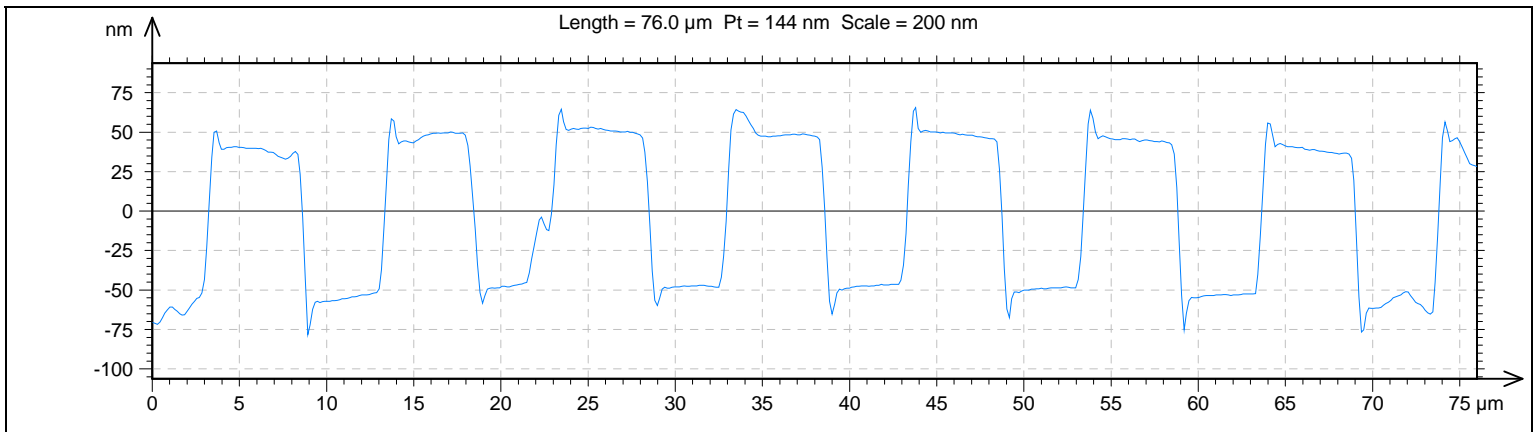

For demonstration purposes only!



Mean depth = 98.1 nm

Correcte

Value: 100 nm

Tolerance 5.50 nm

Horizontal distance (0-1) = 10.1 μm

Correcte

Value: 10.0 μm

Tolerance 0.200 μm

For demonstration purposes only!