

## Comprovació de l'estat de calibració del AFM





**Data: 21 gener 2013**

# Especimen de calibració 1

Periode: 0.66  $\mu\text{m}$

Alçada del graó: 0.05  $\mu\text{m}$

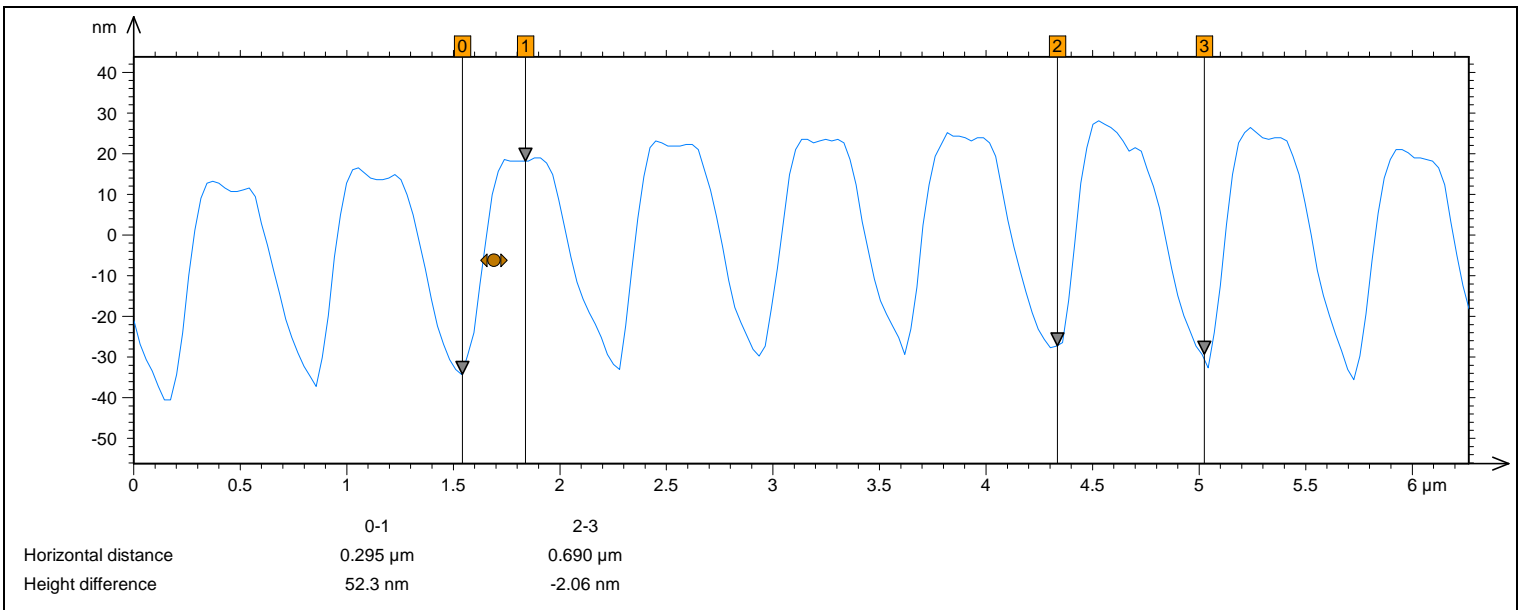
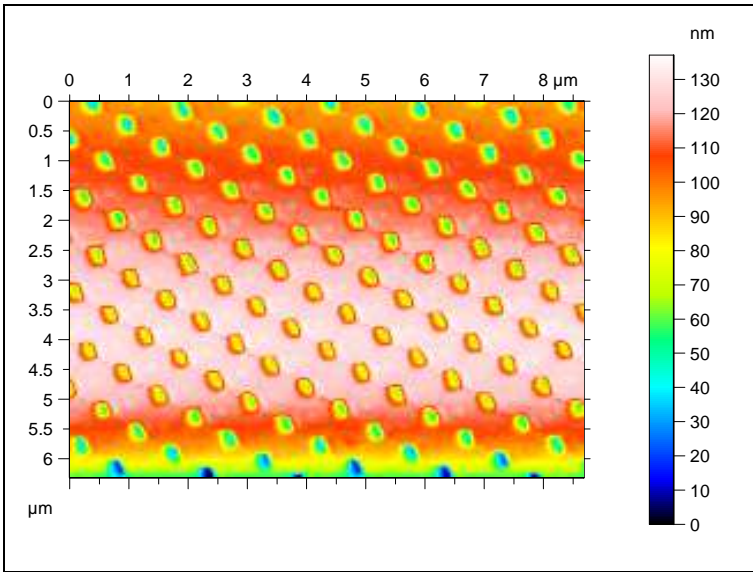


For demonstration purposes only!

# Especimen de calibració 2

Periode: 10  $\mu\text{m}$

Alçada del graó: 0.1  $\mu\text{m}$

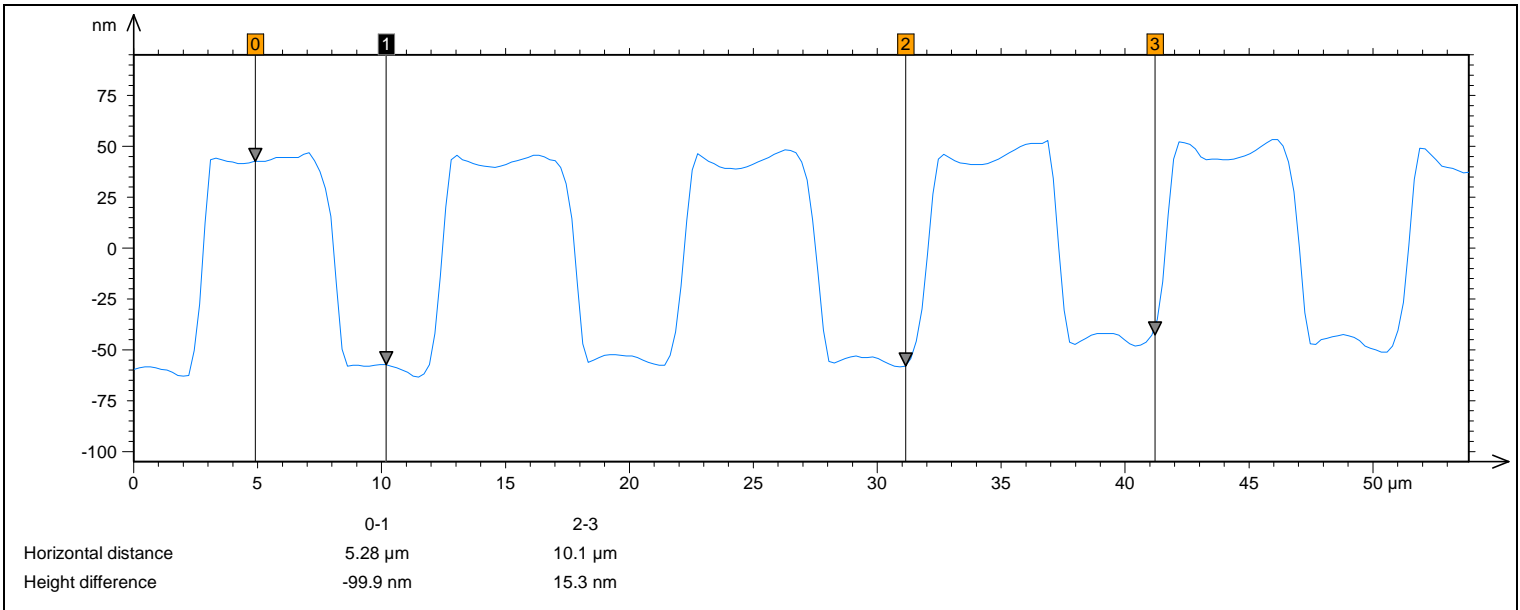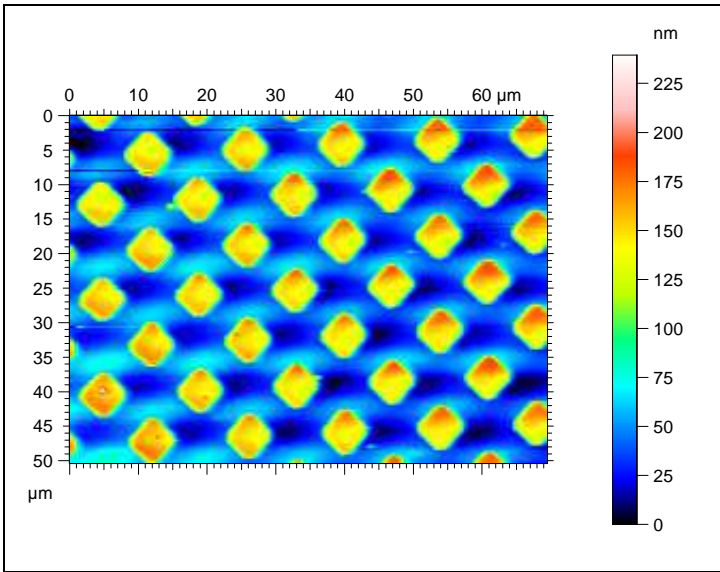

For demonstration purposes only!