


Comprovació de l'estat de calibració del AFM






Data: 18 gener 2018

For demonstration purposes only!

Especimen de calibració 1

Període: 0.66 μm
 Alçada del graó: 0.05 μm

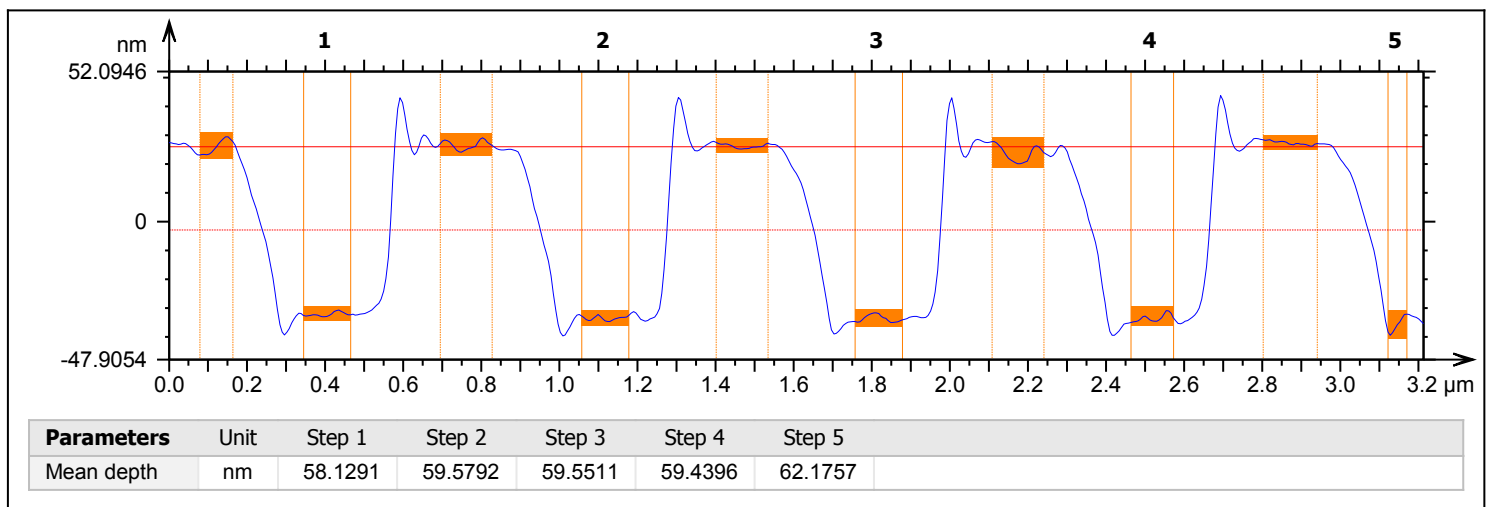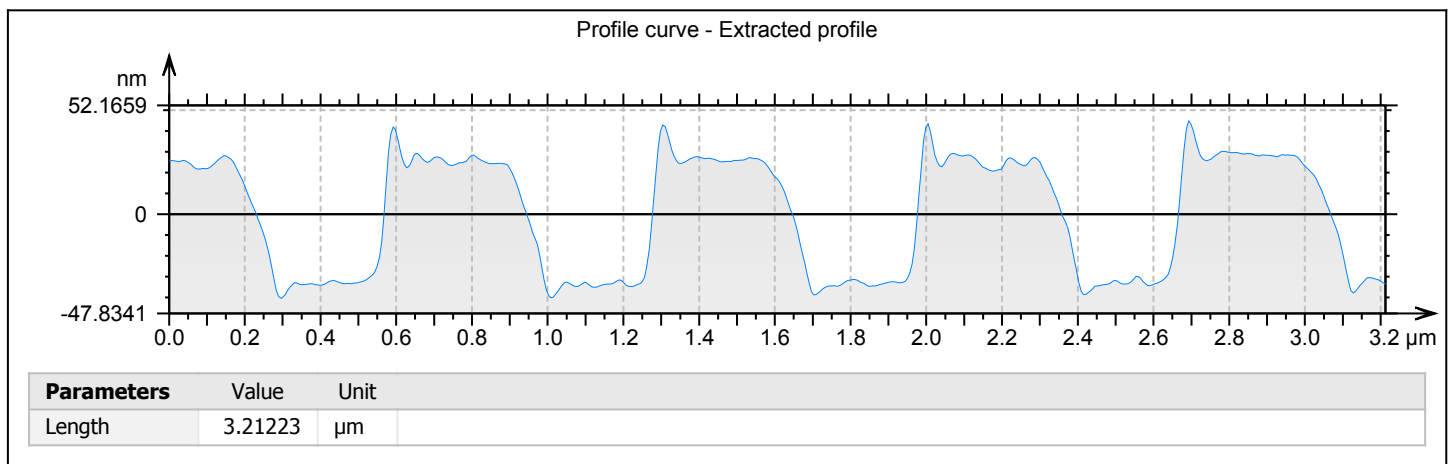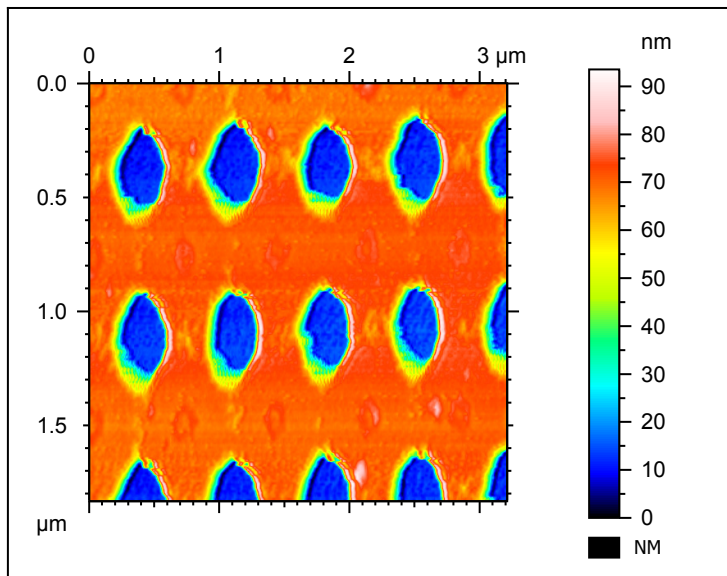


For demonstration purposes only!


Especimen de calibració 2

Periode: 10.0 μm


Alçada del graó: 0.10 μm

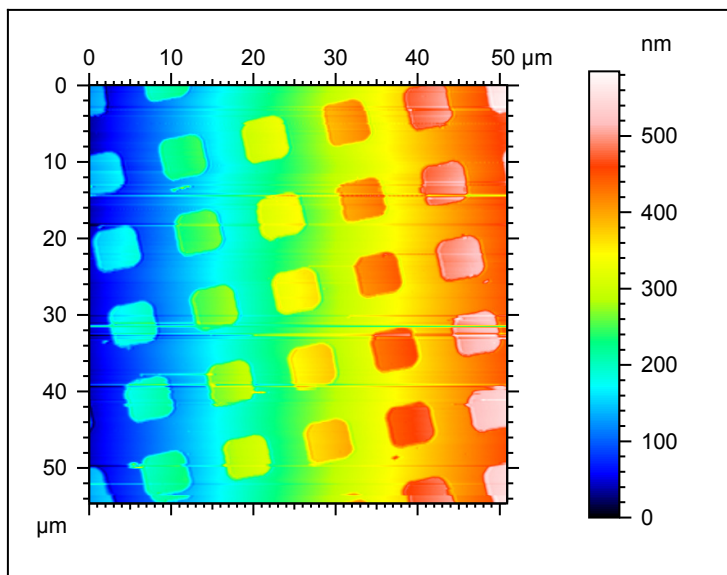

Profile curve - Leveled (Least squares method)

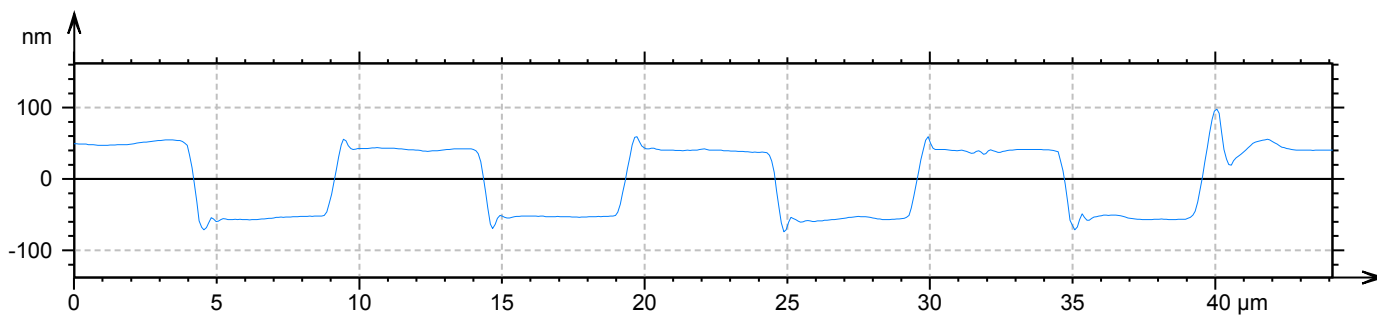

Parameters	Value	Unit
Length	44.1037	μm



Parameters	Unit	Step 1	Step 2	Step 3	Step 4
Mean depth	nm	100.066	96.0484	97.7391	94.6279

For demonstration purposes only!