


Comprovació de l'estat de calibració del AFM

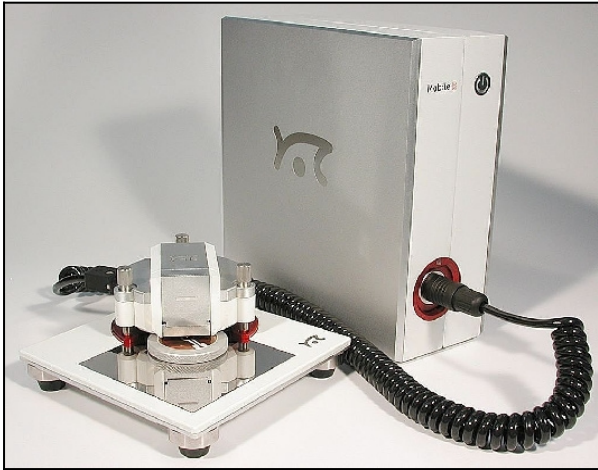



Data: 12 Febrer 2019

For demonstration purposes only!

Especimen de calibració 1

Període: 0.66 μm

Alçada del graó: 0.05 μm

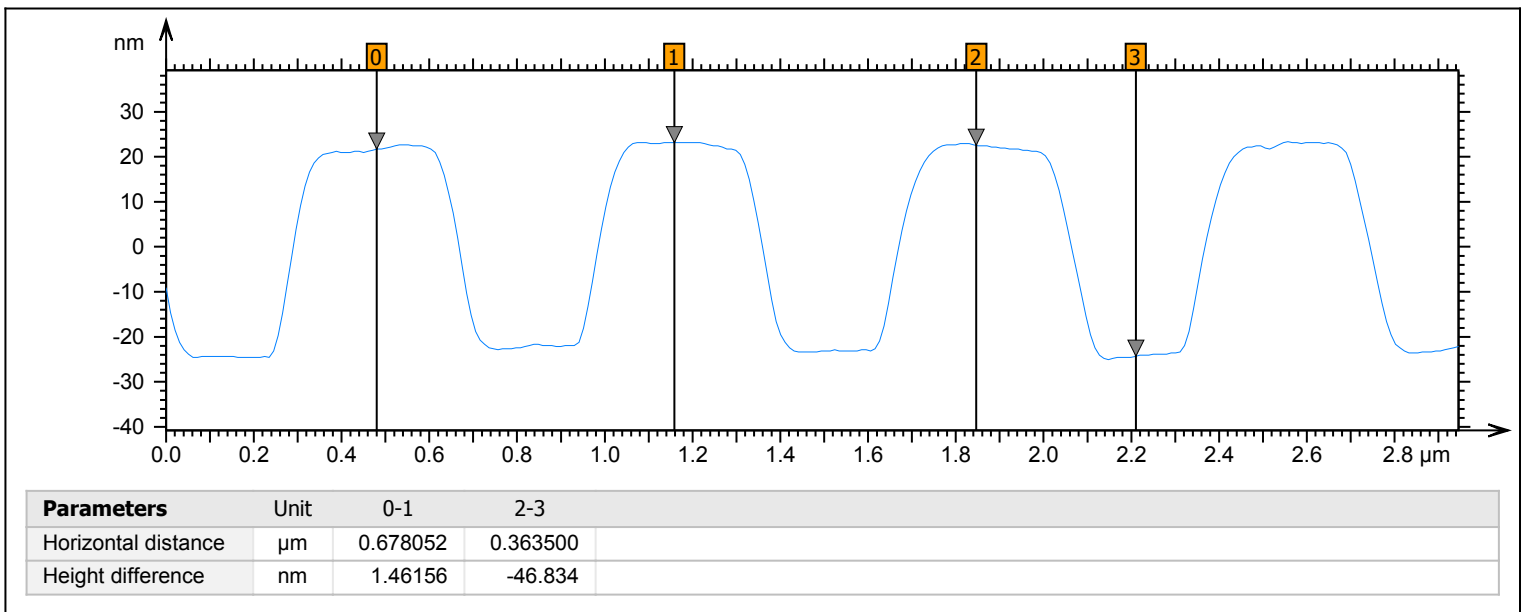
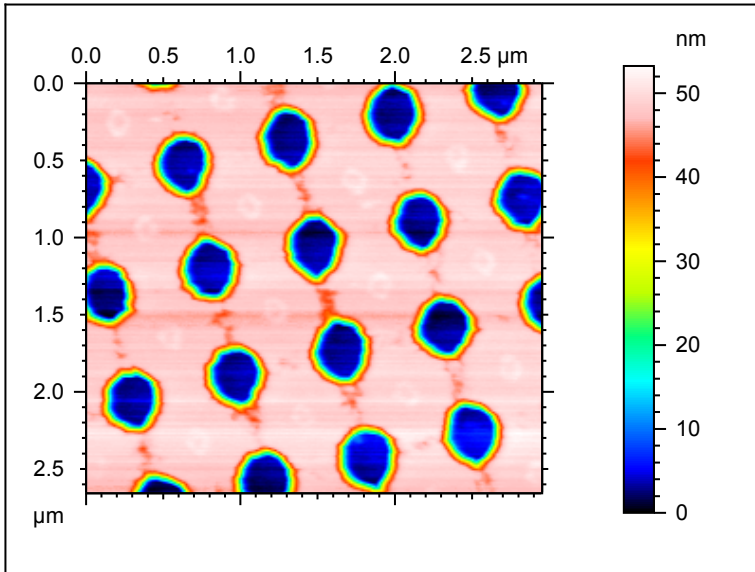


For demonstration purposes only!

Especimen de calibració 2

Període: 10 μm

Alçada del graó: 0.1 μm

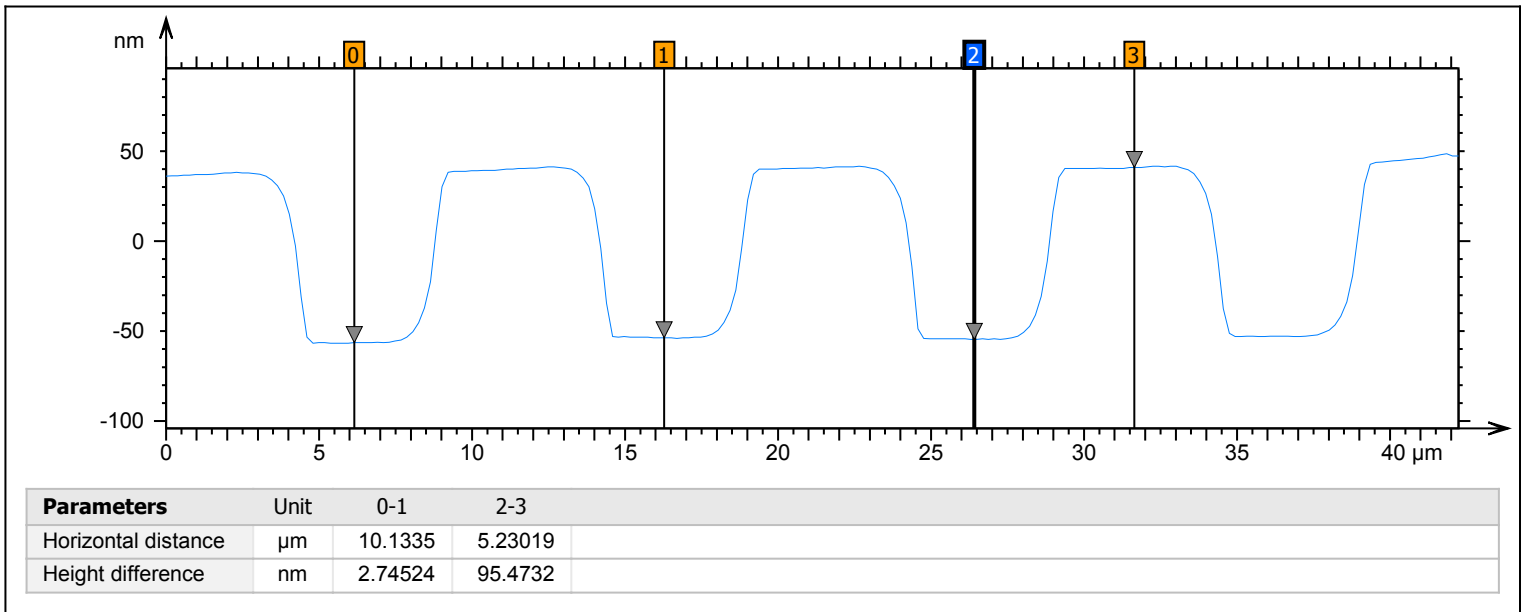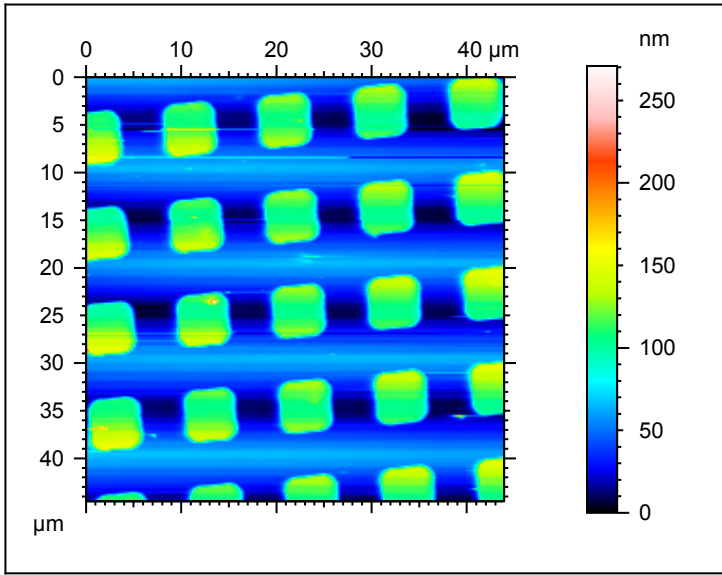

For demonstration purposes only!